


動作確認チェックシート

検査日	2021年 1月 18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	紫外線照射機	主電源電圧	1φ100-240V 300VA	装置Ser.No.	AM4191
製造年月	—	周波数	50・60Hz兼用	メーカー名	浜松ホトニクス
ランプハウス寸法	縦360mm×横163mm×高さ245mm	ランプ	L8251 (No.PP1144)	ランプ点灯時間	2788h
ランプハウス重量	約6.6kg	装置型名	L8333-01	ファイバー	付属なし

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	※○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認。→問題はランプ状態にあり。※ランプ点灯時間約2700Hの為、
ランプ表面の一部が薄く白く濁っている。又、ファイバー・外部入出力コネクタ付属なし。
- 2、通電動作確認。→問題なし。(但し、外部入出力信号未確認。)
(2-1、カバーインターロック及び各表示・操作スイッチ動作確認。)
(2-2、手動操作でパワー切換えが、都度設定入力により切換えの為、都度確認。)
- 3、紫外線照度確認をシャッターオート運転(AUTO)で測定確認。→問題なし。(距離70mmの照度測定。)

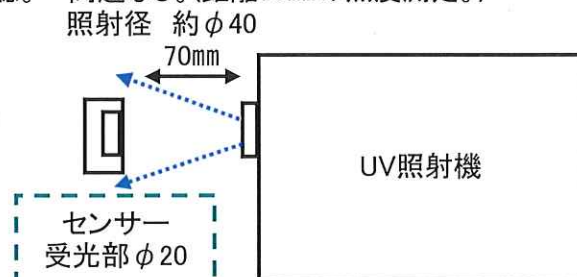

社内計測器 UVメータ
オーク製作所製/OV-M02
No.0158600
センサーUV-25/UV-35/UV-42

センサー種類	LAMP POWER LEVEL 表示値					備考
	0	25	50	75	100(MAX)	
UV-25	0.00	2.08	4.1	6.20	8.12	UV照射機出口とセンサーとの距離70mmで測定(単位:mW/cm ²)
UV-35	0.00	75.8	147.4	221.1	295.8	
UV-42	0.00	57.4	111.9	159.3	210.2	

ランプ表面薄く白色



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(条件付OK) 作業工数[3 H] ランプは点灯動作するが、交換必要。

検査担当者[小林(克)]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

