


管理番号

FA0293

動作確認チェックシート

検査日	2024年12月12日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	オイルフリースクロール真空ポンプ	電源・電圧	3相 200V	冷却法	空冷
型式	DVSL-1002	周波数	50・60 Hz	モーター出力	3.0 (1.5×2) KW
メーカー名	アネスト岩田	吸気フランジ	RC1(NW40)	定格電流値(合計)	11A(5.5×2)
機械Ser.No	HE001	排気フランジ	NW25		
製造年月	—	到達圧力	≤30Pa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	×
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	※1○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

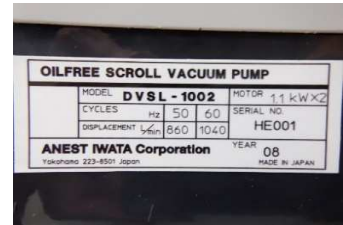

※1 到達圧力: 42Pa

電流値: 7.46A

* 暖気運転60分後、再起動時の測定値です。

* 測定値は規格を満たしておりません又、起動中の異音も大きい為、オーバーホールを推奨致します。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(異音NG) 到達圧力(NG) 作業時間(2.5H)

検査担当者[立野]



ユーザー名【 】出荷日 年 月 日