管理番号

FA0296

動作確認チェックシート

検査日	2019年10月11日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	オイルフリースクロール真空ポンプ	電源・電圧	3相　200V	冷却法	空冷
型式	DVSL-1002	周波数	50・ 60 Hz	モーター出力	3.0 (1.5×2) KW
メーカー名	アネスト岩田	吸気フランジ	RC1(NW40)	定格電流値（合計）	11A(5.5×2)
機械Ser,No	GJ003	排気フランジ	NW25		
製造年月	―	到達圧力	≦30Pa		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

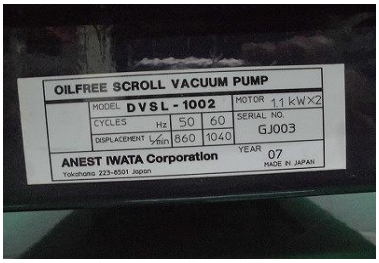

到達圧力：15Pa　　電流値：　8.1A

＊起動1時間後の測定値です。

＊到達圧力は規格値を満たしております。

取扱説明書（ 無 ）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File　Maker入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作（ OK ）　作業工数［ 2.0H ］

検査担当者［　立野　］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

天野

ASK INDEX