

動作確認チェックシート

検査日	2023年 4月 21日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	スポットUV照射装置	主電源電圧	1φ100V 320W	装置Ser.No.	0273
製造年月	不明	周波数	50・60Hz兼用	メーカー名	モリテックス
本体装置寸法	縦330mm×横204mm×高さ164mm	ランプ	LUM-202/1本	ランプ点灯時間	10064.7h
重量	約7kg	装置型名	MUV-202U	ファイバー	U-TECHNOLOGY


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認。→カバーに多少傷があるが問題なし。(付属スポットフレキ外径: φ10 ファイバー径: φ5 長さ2700mm)
- 2、通電動作確認。→問題なし。但し、LAMP ON時、ランプ安定LED(STABLE)→点灯するまで約7分~20分位かかる。
 - 2-1、カバーインターロック・各スイッチ操作・ランプ点灯・シャッター用タイマー確認及び各表示系動作確認。
 - 2-2、ランプ点灯安定時、POWER ADJ.は内部スリット機構無しのため、UVランプ光源が直に出力されるのを確認。
 - 2-3、その他、外部リモート操作は未確認。
- 3、UV照射(紫外線照度)確認。→MAX照射時、安定的に照射問題なし。(下記照度測定参考)

センサー測定器	UV-25	UV-35	UV-42	測定器/センサー
1		66	304	UIT101/UVD-365・UVD-405
2		66.9		UIT250A/UVD-S365

測定値単位: mW/cm²

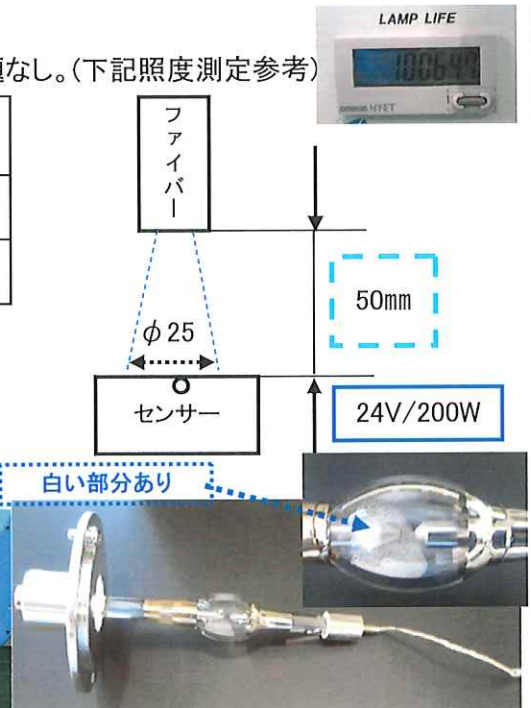

2019年頃はメーカーより、ランプ在庫6個有り。
(価格: オープン価格 概算約10万円前後)であった。

取扱説明書(有)コピー品

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4H]
 検査担当者[小林(克)]
 ユーザー名[]

】出荷日 年 月 日

