

管理番号

GC0834

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2020年 7月 21日
名称	顕微鏡(実体)
メーカー	メイジテクノ
型式	RZ
S/N	—
年式	— 年 — 月

【外観】




【仕様】

光学系	平行系(ズーム変倍式)	鏡筒	双眼鏡筒
		各種フィルター	—
総合倍率	7.5× ~ 750×	ステージ	—
		ステージストローク	—
ズーム範囲	0.75× ~ 75×		
		レボルバー	—
接眼レンズ	UWF10x	その他	
		照明装置	落射/透過

視野内画像



※ズーム倍率25以上になると
視野画像が二重に見える

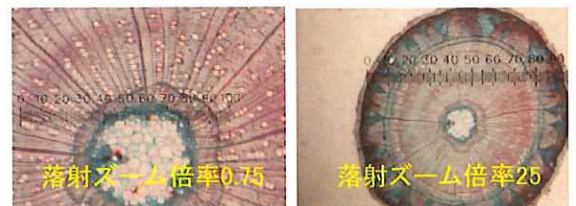

※ズーム倍率30以上になると
視野画像が二重に見える

チェック項目

■ コンディション

評価

総合	視野内観察画像が二重に見える 倍率がある。(25x以上 落射/透過共に)
外観	問題なし
光学系	問題なし
駆動系	問題なし
照明	問題なし

取扱説明書: 無

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作: OK 作業工数[1.5 hr]
検査担当者[雨宮]

※観察画像が二重に見えてくる倍率がある。

