


動作確認チェックシート

検査日	2017年 10月 10日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリーエバポレーター	電源電圧	3相 単相 100V 35 VA	重量	8kg
型式	NA-1	周波数	(50・60)Hz兼用		
メーカー名	アズワン(株)	純正パーツ	NA-1SGS型		
機械Ser.No	60712208	回転数	20~180rpm		
製造年月	不明	外寸法	D320×W670×H790		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	本体○(部品×)
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


- 1、外観確認において、純正パーツ部品で、ガラス部部品が欠品しているため組立確認が出来ない。
又、本体汚れ多少あり。(ボールジョイントクリップ、アイラクリップ、ノズル3個。)
- 2、本体回転機構部及び上下機構部動作確認実施。 動作OK

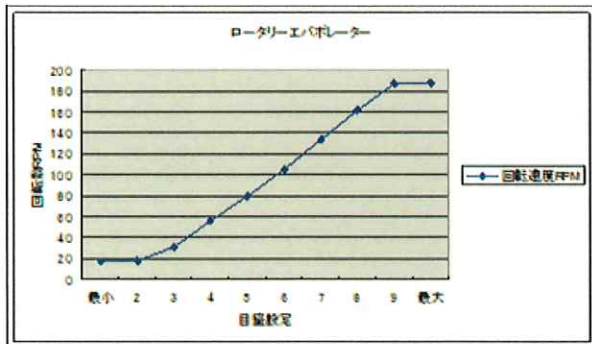

目盛	最小	2	3	4	5	6	7	8	9	最大
回転速度RPM	18	18	32	56	80	106	134	162	186	188

タコメータ
HT-5100 小野測器
管理No.TA9931 を使用

2023年8月26日再点検
小エバ回転: 目盛 3 5 7 MAX
測定(Ymin) 2k 50 1.3 1.87
問題なし 野村

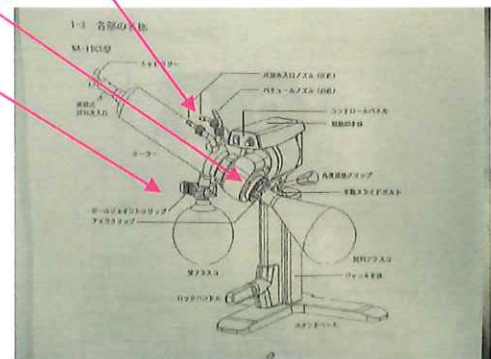

取扱説明書(有) 無) コピー品

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]
 動作(OK) NG) 作業工数[3 H] 純正パーツに欠品部品があるが、本体の機能・動作OK。
 検査担当者[小林克]
 ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

