

管理番号

H60561


動作確認チェックシート

検査日	2023年7月7日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	三次元攪拌機	電源電圧	1相 100V	外寸	W420D430H220
型式	PROMAX2020	周波数	50 Hz	重量	18 Kg
メーカー名	Heidolph	回転速度	20~400 rpm		
機械Ser.No	030301419	動作	往復動作		
製造年月	年 月	タイマー	最大120min		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし

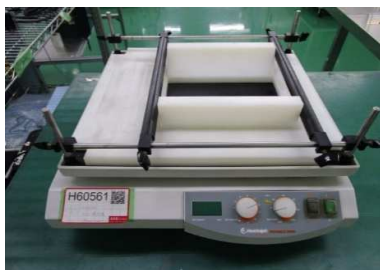

・攪拌

最小回転数(20rpm) : 23rpm確認

調整ボリューム5目盛 : 164rpm確認

最大回転数(400rpm) : 調整ボリュームMaxで383rpmまで確認



Min 23rpm



5目盛 164rpm



Max 383rpm

・通電確認

電源ランプ点灯 確認

回転数表示確認



タイマー動作

設定時間経過で停止(ブザー鳴) 確認

攪拌動作 動画有り

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数[2H]

Max回転数 383rpm

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

