

管理番号

HA0917

## 再動作確認チェックシート


検査日	2024年3月29日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ピラニ真空計センサユニット	電源	DC24V	適用ディスプレイ	ISG1(DC24V)
型式	SP1	測定範囲	0.4~3000Pa	適用ディスプレイ	IM1R1(DC24V)
メーカー名	アルバック	使用周囲温度	10~40℃	適用ディスプレイ	IM2R1(AC100V)
機械Ser.No	26462G	耐熱温度	80℃	質量(本体のみ)	190g
製造年月	—	測定子適用型式	WP-01,02,03,16		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

## 【 検査環境 】

- \* 社内排気セット : RP +TMP \* 今回はRPのみ起動
- \* 社内用測定機器: ディスプレイ (アルバック製 ISG1) / 測定子 (アルバック製 SW1)
- \* 社内用測定機器: ディスプレイ (アルバック製 IM1R1) / ピラニ真空計センサユニット (アルバック製 SP1)

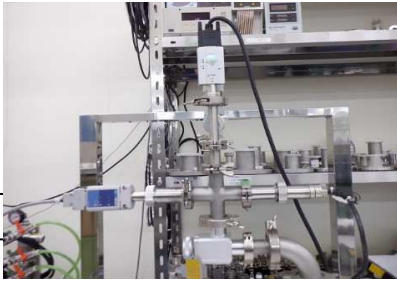

センサユニット(SP1) \* 測定子:WP-01



ISG1(ディスプレイ表示)

測定圧力: 1.5Pa



IM1R1(ディスプレイ表示)

測定圧力: 2.3Pa

取扱説明書(無) \* 社内用測定機器を使用し比較測定結果です。(ディスプレイ: ISG1・IM1R1)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1.5H ]

検査担当者[ 立野 ]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

