

管理番号

I70050

動作確認チェックシート

(機械の仕様・規格を記入する。)

検査日	2021年 8月 26日				
商品名	フオースゲージ(デジタル)	電源電圧	単相 100~240V ACアダプター 7.5V 0.8A	許容過負荷	150%
型式	ZPS-LM-1000N	周波数	50 / 60 Hz		Φ20×H8.5
メーカー名	IMADA	測定範囲	max 1000 N(100Kgf)		
機械Ser.No	249449	最小単位	1 N		
製造年月	年 月	ロードセル	LM-1000N		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ ON/OFF, ZERO, PEAK, SEND


◎ 表示類 ○ 荷重表示 確認

◎ 動作 ○ 10Kg, 20Kg 標準錘使用

標準錘 Kg	本体表示値 N
10	98~ 100
20	196~ 200



10 Kg

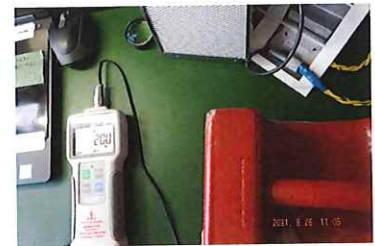

20 Kg

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2H]

検査担当者[佐藤]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

