

I70184


動作確認チェックシート

検査日	2018年 7月 19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	イオナイザー(セット品)	電源電圧	AC100V 0.3A	出力電圧方式	DC±7KV出力
製造年月	不明	除電バー型名	モデル453	放電針	シリコン×4本
メーカー名	ヒューグルエレクトロニクス	全体質量	約1400g	モデル470コントローラ対応	
寸法(全長)	622mm (電極 4極)	除電バーSer.No.	0105088	コントローラ Ser.No.: 0009059	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観・電極磨耗確認及びブクリーニング実施。→電極局数4本の針先端消耗少々有。特に問題なし。
- 2、除電確認実施。→動作OK。(社内計測器NK-7001により除電確認。及び、イオンバランス確認。)
 (除電確認:中央と両端中央より±175mm付近、除電距離500mm付近での確認。)
 (コントローラ+除電バー:正・負イオン発生ADJボリューム動作・PULSE RATEボリューム動作確認。)
 (コントローラ:PULSED-DC 動作確認。)

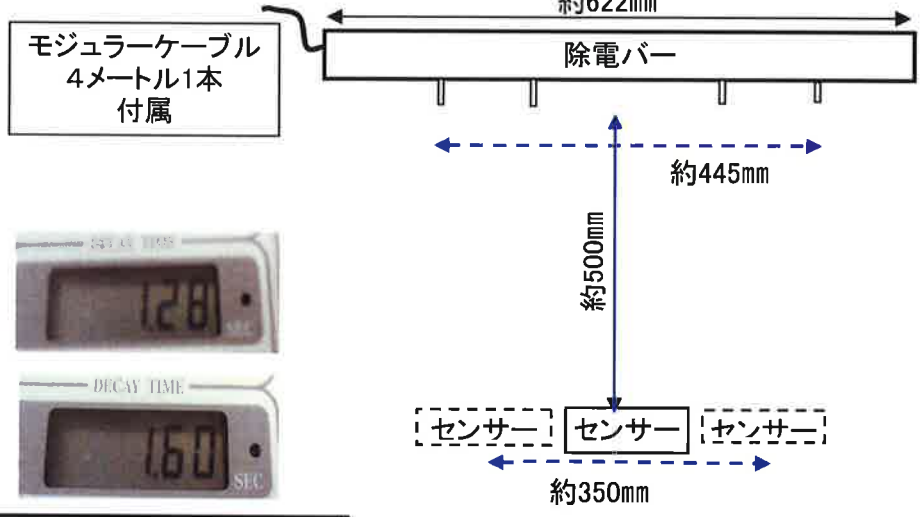

モジュラーケーブル
4メートル1本
付属



MODEL-453/0105088			
除電時間	左	中央	右
+1000V→+100V	0.96秒	1.28秒	1.20秒
-1000V→-100V	1.14秒	1.60秒	1.60秒
イオンバランス	+200V/-300V	+200V/-300V	+200V/-400V

動作確認
環境
室温28度/湿度50%

除電時間:約±1000V→±100Vになるまでの減衰時間(目安時間)
正・負イオン発生ADJボリューム・PULSE RATEボリューム最大設定

取扱説明書(有/無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(OK/NG) 作業工数[2.0 H]

検査担当者[小林(克)]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日