

動作確認チェックシート

検査日	2025年1月31日	製造年月	不明		
商品名	真空計(イオンゲージ)	電源電圧	AC100V		
測定子型式	不明	コントローラ外寸(mm)	W240×D300×H90		
コントローラ型式	Type290C-01	コントローラ重量	4.5kg		
メーカー名	MKS				
機械Ser,No	96052213A				


	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6	データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未対象・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等)

- 1, 外観確認: 正常、測定子、コントローラ本体に著しい傷や破損等の異常無し
- 2, 通電確認: 正常、通電時の異常発生無し
- 3, 動作確認: 正常、電源ONでフィラメントONを確認済、圧力表示確認済(圧力単位: Torrのみ)
※Degas動作はリモートケーブルが無い為、未確認
・弊社真空治具に測定子を接続、弊社真空治具とコントローラ真空度表示は概ね同等
- 4, 付属品: 測定子ケーブル
※測定子ケーブル長: 約400mm



コントローラ正面

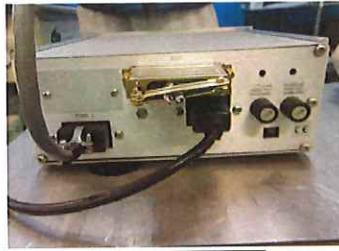

コントローラ背面



測定環境



測定子



測定子ケーブル

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3.0 H]

検査担当者[遠藤]

ユーザー名【

】出荷日 年 月 日

早川