管理番号

J10612

動作確認チェックシート

検査日	2020年2月27日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ターボ分子ポンプセット	電源・電圧	単相　200～220V	冷却法	水冷
型式	TC1810VW/TC1810	周波数	50 / 60 Hz	定常時出力周波数	340Hz
メーカー名	大阪真空	吸気フランジ	JIS VG250	排気速度 N2	1800L/s
機械Ser,No	1551 / A138902-14	排気フランジ	NW40	軸受方式	油潤滑玉軸受
製造年月日	2000年10月	重量	80/9Kg	取付姿勢	垂直（±10°）

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

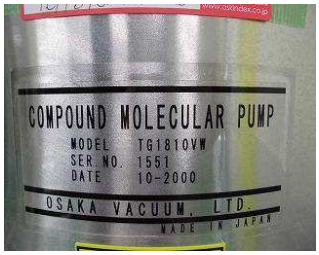

・NORMAL時の到達圧力：2.5×10^{-4}Pa

＊LOCAL運転にて動作確認実施致しました。

・STARTにて（加速）し正常にNORMAL(定常回転：340HZ)に到達致しました。

・STOPにて(降速）し正常にSTOP(停止）しました。

取扱説明書（ 無 ）　　＊別紙にて加速/ 降速時の写真を添付しております。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作(OK)　　作業工数[5.0H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日