

管理番号


J30516

動作確認チェックシート

検査日	2023年 1月 18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	RF電源	電源	単相 200V	最大出力	600W
型式	AX-600Ⅲ-N-EI	周波数	50/60Hz	定格周波数	13.56MHz
メーカー名	ADTEC	電力	1.4kVA		
機械Ser.No	126000045				
製造年月	不明				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

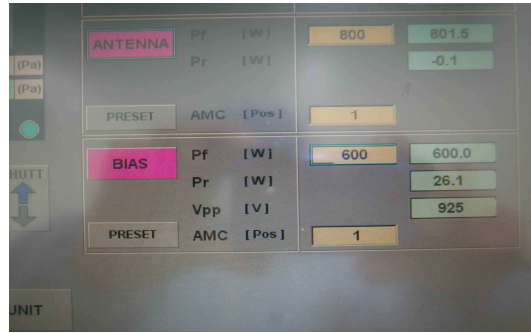

RF電源最大出力600Wにて確認

RF電源		装置モニター画面	
Pf	Pr	Pf	Pr
600W	24W	600W	26.1W

※ULVAC NE550 ドライエッチング装置にて動作確認実施
異常放電無し

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3H]

検査担当者[今村 和彦]



ユーザー名【 】出荷日 年 月 日