
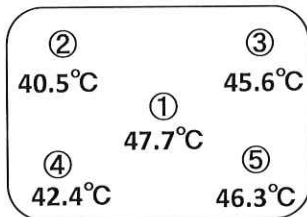


検査日	2022年7月15日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ホットプレート	電源	AC 100V		
型式	PC-300	周波数	50/60Hz		
メーカー名	コーニング	出力	555W		
機械Ser,No	9216	プレート寸法	195x160mm		
製造年月	—				


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。 at23°C


- 電源投入(異音・異臭等)確認⇒問題なし。
- 温度設定(ダイヤル式)確認⇒設定low,4,higt問題なし。

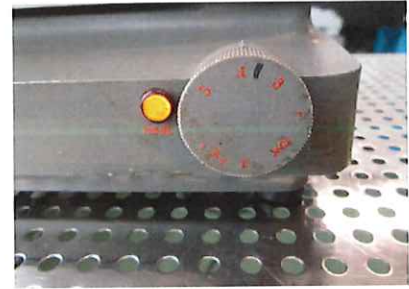

設定:Low温度分布  
Ave:44.5°C

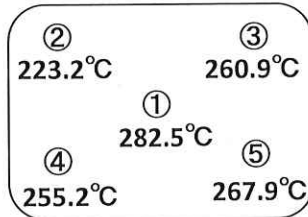

設定:4温度分布  
Ave:257.94°C

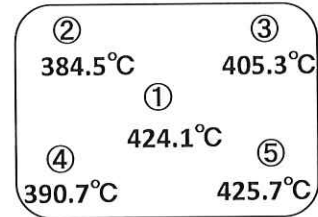

設定:High温度分布  
Ave:406.06°C

温度実測  
(使用機器:弊社所有温度計  
IT2-80 -50~500°C/KEYENCE)

取扱説明書:無

※表面温度計は付属していません。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]  
 動作:条件付きOK 作業工数[ 3.0 hr ]  
 検査担当者[ 雨宮 ]

