

動作確認チェックシート

検査日	2022年 8月 17日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	硬度計(ゴム用)	機械Ser.No	23514	測定方式	ばね式
型式	JIS	質量	190g	測定範囲	メータ値0~100
メーカー名	島津製作所	表示	アナログ式		0~1000g
外寸	60×20×75mm			誤差	0度±8g



チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	—
3 SW設定	SWの機能は正常か。又、評価機能は満たしているか。	※
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認実施。→問題なし。(但し、収納ケースは一部破損汚れ有)
- 2、荷重動作確認実施。→荷重とメータ値との整合が、荷重が大きくなるとズレが増える。
※動作はするが、絶対値が誤差を考慮してもズレが大きい。

動作確認

測定データ		
No.	メータ読み	荷重測定値g
1	10	115.7
2	30	297.5
3	50	480.5
4	70	635.5
5	90	794.0

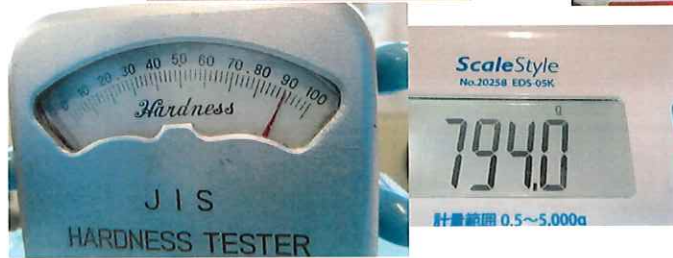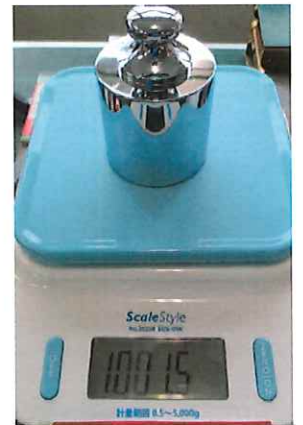

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]
 動作(保留) 作業工数[2H] 校正用硬度ゴム材との比較校正が必要。
 検査担当者[小林克]
 ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

