


工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2019年 11 月 12日
名称	測長顕微鏡
メーカー	OLYMPUS
型式	STM-UM
S/N	312002
年式	不明

【外観】

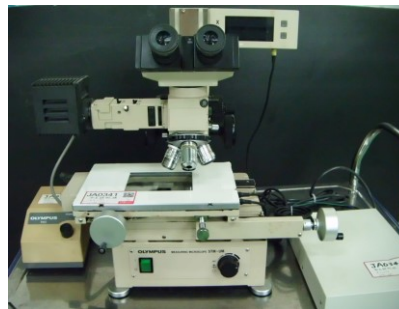

【仕様】

照明系	12V 50W ハロゲンランプ	サイズ(本体)	540x490x495
接眼レンズ	MMOC 10x		
鏡筒	双眼鏡筒		
対物レンズ	5x 10x 100x		
測定範囲	X=100mm Y=50mm		

チェック項目

■ コンディション

評価

総合 メカ系特に問題無し


外観 特に問題無し

光学系 特に問題なし

駆動系 特に問題無し

照明 特に問題無し

取扱説明書(有(無))



Mitutoyoブロックゲージ25、50mmにて測定

X方向

基準寸法	1回目	2回目	3回目	R
25mm	24.9995	24.9999	25.0000	0.0010
50mm	49.9998	49.9990	49.9995	0.0008

Y方向

基準寸法	1回目	2回目	3回目	R
25mm	24.9990	24.9996	24.9990	0.0006
50mm	49.9995	49.9985	49.9990	0.0010

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

【責任者】

動作(OK・NG) 作業工数[1.5 H]

検査担当者[宮下]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

