

# 動作確認チェックシート

|          |                  |                  |                         |        |        |
|----------|------------------|------------------|-------------------------|--------|--------|
| 検査日      | 2023年 2月 15日     | (機械の仕様・規格を記入する。) |                         |        |        |
| 商品名      | 電子秤              | 電源電圧             | 駆動DC9V/0.6A<br>専用ACアダプタ | 直線性    | 詳細不明   |
| 型式       | HV-30K           |                  |                         | 再現性    |        |
| メーカー名    | エーアンドディー         | 計量皿寸法            | W340×D435mm             | 分解能    |        |
| 機械Ser.No | J8 404648        | ひょう量(最大)         | 3kg                     | セット品重量 | 約9.2kg |
| 本体寸法     | W340×D435×H110mm | ひょう量(最小)         | 10g                     | 付属品    | なし     |

| チェック項目    | 主な確認内容                                 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観      | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。   | ○        |
| 2 起動動作    | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○        |
| 3 SW設定    | SWの機能は正常か。                             | ○        |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。          | ○        |
| 5 確認シール   | 動作確認済シールを貼る                            | ○        |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認。→外観多少汚れがあるが、確認問題なし。  
但し、表示コントローラ部と重量測定部は分離している。
- 2、社内測定用おもりにて計量測定実施。→計量は動作問題なし。


## 動作確認

### 計量測定

| 直線性及び最小読取値     |         |      |
|----------------|---------|------|
| 測定用重り          | 測定表示値kg | 備考   |
| 10g            | 0.01    |      |
| 100g           | 0.10    |      |
| 500g           | 0.50    |      |
| 1kg            | 1.00    |      |
| 5+2kg+500g     | 7.49    | 25%  |
| 10kg           | 9.99    |      |
| 10+5kg         | 14.98   | 50%  |
| 10+10+2kg+500g | 22.47   | 75%  |
| 10+10+10kg     | 29.96   | 100% |
| 最大誤差           | 0.04kg  |      |

### 天秤皿5ポイント測定

#### 計量皿内バラツキ

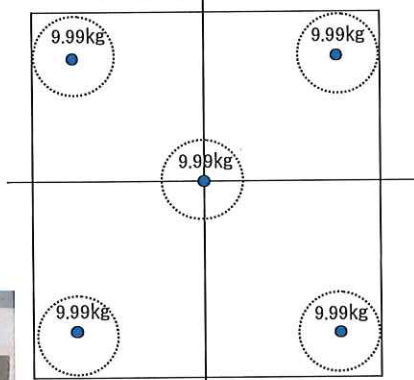

### 繰返し測定

| 繰返し性 |         |
|------|---------|
| 回数   | 測定表示値kg |
| 1    | 9.99    |
| 2    | 9.99    |
| 3    | 9.99    |
| 4    | 9.99    |
| 5    | 9.99    |



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
|     |         |     |

File Maker入力

動作(OK) 作業工数[ 3H ]  
 検査担当者[ 小林 (克) ]  
 ユーザー名[ ]

(備考欄コメント)

[責任者]

】出荷日 年 月 日

