

管理番号

L40210

動作確認チェックシート (アルミブロック恒温槽)



検査日	2024年 03月 22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
型式	DTU-1B	電源電圧	AC100V 1.5A	外寸(WxDxH)	210x318x130mm
メーカー名	タイテック(株)	周波数	50/60Hz	重量	約4Kg
機械Ser.No	0093550	温度範囲	R.T+5~110℃	付属ブロック	φ17x25穴
製造年月	不明(推定1999年頃)	冷凍機	なし		

チェック項目	主 な 確 認 内 容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

最高・最低温度到達時間	備考(動作確認内容・不具合内容等)
18.0℃→37.0℃	約 6分
37.0℃→110.0℃	約 28分
条件: Ta≒20℃、ロック装填、Vin≒107V	



設定温度37℃と設定温度110℃での運転

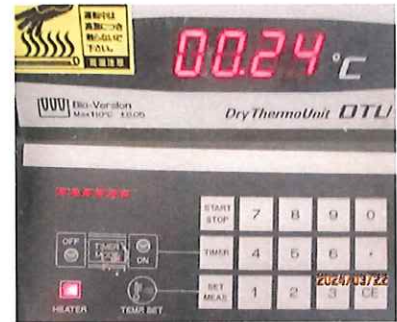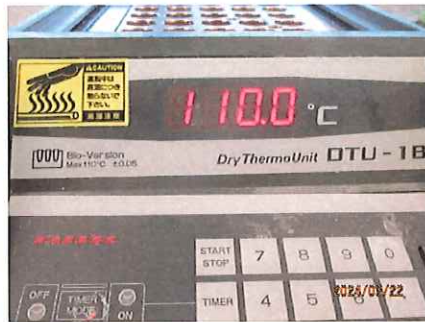

OFFタイマー運転(あと24分後OFF)

取扱説明書(あり)

修理・改造履歴

年 月 日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK)	作業工数[2.0 H]	O.K
検査担当者[小林 隆志]		
ユーザー名[]	】出荷日	年 月 日

