

動作確認チェックシート


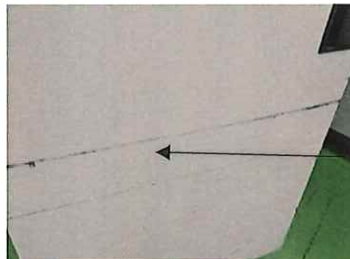
検査日	2022年1月6日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クリーンオープン	電源電圧	三相200V19A	キャスター、アジャスター付き	
型式	PVC-230	周波数	(50 / 60)Hz	重量	270Kg
メーカー名	エスペック	内寸wxdxh	580x480x1080		
機械Ser.No	251001243	外寸wxdxh	780x970x1980		
製造年月	1993	棚板	4枚		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4		
5 消費電流	クランプで実測。	
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 ダンパー閉で左側からビニールチューブ導入、弊社パーティクルカウンターで1分4回測定平均、0.3μm 8個、0.5μm3個、であった、室温21°C庫内温度28°C、設定温度200°C、約45分で到達。


11.0-パーティクルカウンター 2.83L/min

前面扉傷



18mmH2O



200°C

左側からビニールチューブ導入
取扱説明書(ディスプレイのみ)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

