

M10240

動作確認チェックシート (再確認 2024.11.18)

検査日	11月30日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デシケーター(オートドライ)	電源	AC100V		
型式	SDC-1202-05	周波数	50/60Hz		
メーカー名	東洋リビング	庫内寸法	W1150 D630 H1540		
機械Ser.No	110818	外寸	W1200 D780 H1800		
製造年月	2009年	棚板	5枚(底板含む)		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
4 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

動作確認 除湿は、約55%→24%まで下がった。(約30Hr後確認)・循環ファン OK

温湿度計(アスワン):型式THA-01M測定値:54%→18%と表示

通常のオートドライスペック30~50%RH以下になっているので、OKと判断する。



電源を入れる前

約30Hr後の値


取扱説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

Shirasagi入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業工数[1H]		
検査担当者 [ 中野 ]		中野
ユーザー名【	】出荷日 年 月 日	

再確認 内容 ほぼ約30%以下で稼働できる事で動作 OKとする。  
 約16Hr後が湿度が最低になり、徐々に上がり約30%、再度除湿機能が稼働した状態。

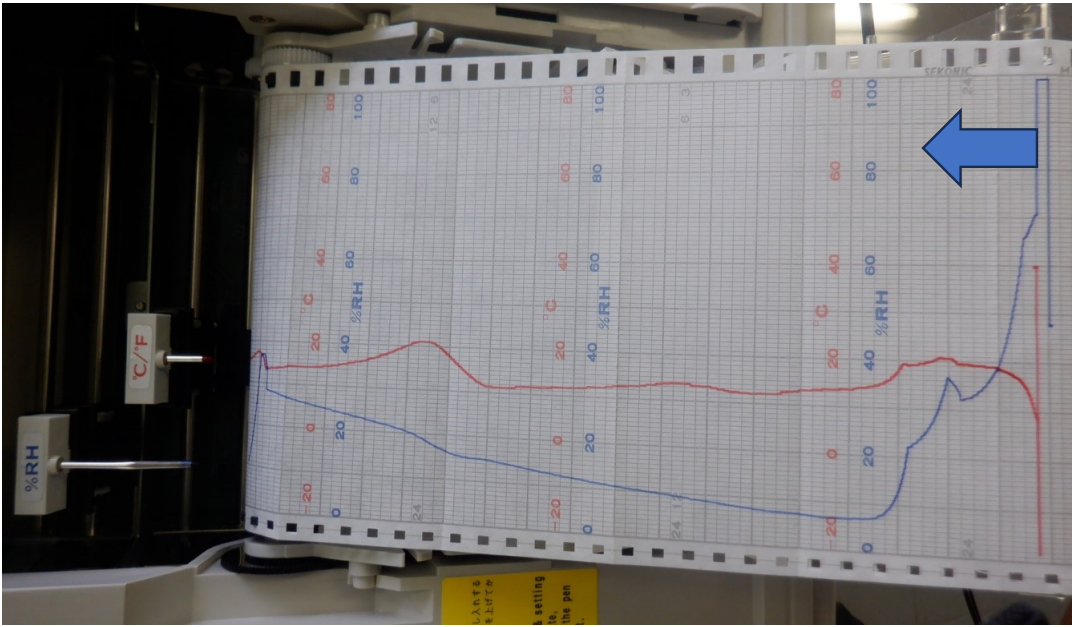

ST-50A温湿度計 温度(赤色)湿度(青色)推移 (2.5mm/h) 約3日稼働記録

開始時



既存メーター: 68%  
 ST-50: 68.4%

開始時



既存メーター: 19%  
 ST-50: 7.6%



FFU稼働スイッチは、点灯しません。