

M10248

動作確認チェックシート

検査日	2024年8月5日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デシケータ(オートドライ、クリーン)	入力電源	AC100V		
型式	SDS-1200S	周波数	50/60HZ		
メーカー名	日本エアータック	FFU	SS-MACx2		
機械Ser.No	D251969715	集塵効率	99.99%(0.3μm)		
製造年月		キャスター付き			


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 内外湿度38%、除湿能力MAX,24h後14.2%確認、庫外37%。
- 下表示の様にしてパーティクル測定、1分5回測定、平均、左0.3μm、7個、右、8個、0.5μm共に0個。

14.20%

庫内センサーIN パーティクルカウンター測定、吸引流量2.83L/min

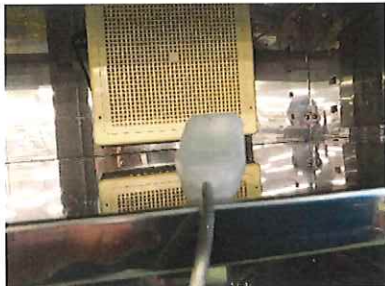

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

