

動作確認チェックシート

検査日	2022年10月20日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	超低温フリーザー	電源電圧	3φ AC200V	温度範囲	-85℃
型式	MDF-DC700VX-PJ	周波数	50/60Hz		
メーカー名	パナソニック	外寸	W2300 D845 H1070		
Ser.No	160011				


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	1730	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ・動作確認は、問題ありません。
20℃→-85℃ 約5時間
- ・バッテリー交換 アラームが出ています。
3年経過すると表示する。バッテリー電圧:6.3Vあります。



表示温度(設定-85℃)

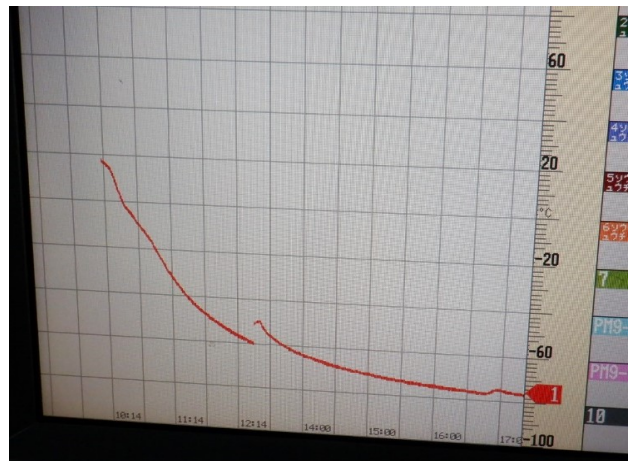

参考: 温度プロファイル(30min/div)

取扱説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]
 動作(OK) 作業工数[2.0Hr]
 検査担当者[中野] 中野
 ユーザー名【 】出荷日 年 月 日