

(管理番号)

M50164

FileMker入力

責任者

検査担当者



坂野


## クライオポンプ動作確認チェックシート

検査日	2024年 10月 4日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クライオポンプ/コンプレッサー	電源電圧	単相 200V	He圧	1.5MPa
型式	CRC-420	周波数	50・60Hz		
メーカー名	アネルバ	冷却法	水冷		
機械Ser.No	226126D				
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. クールダウン時間 20K 98分 CAP-121を使用
2. 到達圧力  $2.47 \times 10^{-4}$  Pa
3. 到達温度 2ND 12.4K
4. 積算時間 54,388H (アドゾーバー交換時間、時期からみて1周してます154,388)

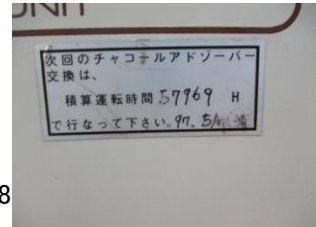

到達圧力



2ND温度



積算計



He圧停止時

取扱説明書(無)

### 修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者
	※アドゾーバーは部品が購入できない為、交換していません。	

File Maker入力 (備考欄コメント)  
動作(OK) 【 工数 3.0 H 】