管理番号

M70282

動作確認チェックシート
（ インキュベーター ）

≪温度範囲≫
＋4℃固定

検査日	2022年 11月 04日				
型式	FCS－280	電源電圧	単相100V 75W	内寸法(W×D×H)	329x219x369mm
メーカー名	アズワン	周波数	(50)・60 Hz	外寸法(W×D×H)	420x413x485mm
機械Ser,No	2021060340058	冷凍機	ペルチェ素子	送風ファン	（ 有 ・(無) ）
製造年月	推定2021年06月	棚 板	(有) 2枚 ・無	ダンパー機構	なし

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・パッキン・ゴム栓・スイッチ等に著しいキズ・破損はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	温度設定SW・その他SWの機能は正常か。	○
4	温度調節機能	仕様温度範囲の調節ができるか。(定置運転)	○
5	プログラム機能	温度制御機能は正常か。	－
6	到達時間	温度設定を最大・最小にした時の到達時間。(下欄に記入)	
7	付加機能	過昇防止器・ファン・差圧計・ダンパー・記録装置・パトライト等は正常か。	－
8	保管・出荷準備	ビス締め・清掃・フィルタの汚れ・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
9	確認シール	動作確認済シールを貼る(右側側面上部または機種名板が側面にあるときは、その近く	○

最高・最低温度到達時間	
20℃→ 5℃	約 1時間
条 件:Ta≒21℃ Vin≒105V	

備　　考 (動作確認追記事項・不具合内容等)

注1. 温度設定も温度表示も機能なし。動作中を示す表示灯のみがある。電源スイッチもなし。

注2. 温度表示機能がないため、熱電対を庫内に取り付けてデーターロガーを使用して温度の計測を行った。

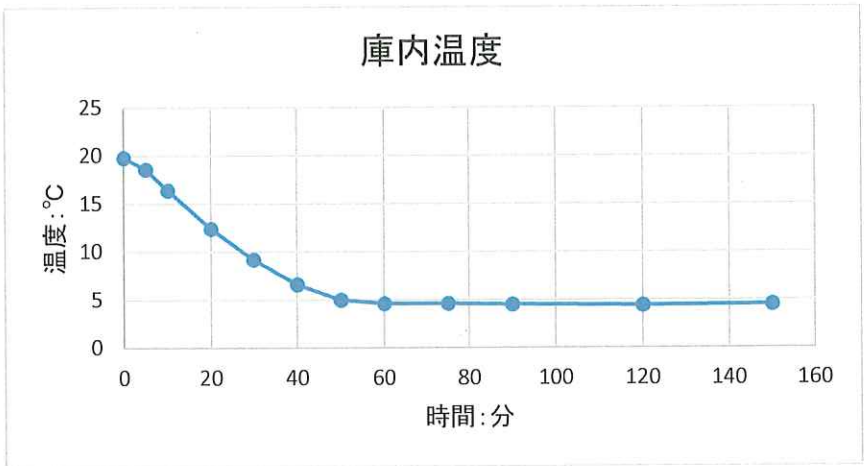

取扱説明書(あり)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力　　(備考欄コメント)　　[責任者]

動作(OK)・NG)　　作業工数[3.0 H]　　O.K

検査担当者[小林 隆志]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日