


動作確認チェックシート

検査日	2022年12月20日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	マイクロ波試料前処理装置	電源電圧	AC220-240V		
型式	ETHOS ONE	周波数	60Hz		
メーカー名	マイルストーン	周波数	50/60Hz		
機械Ser.No	-	キャビティ内部	W350 D350 H350		
製造年月	-				


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	-
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	-
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


- パスワードが不明(記載:123456とあるが間違えている)
設定が出来ない。電源は、入ることは、確認できた。
- 付属品の確認 別紙写真を参照ください。
・セグメンテッド高圧ローター:3セット(一部無いものもある)
・HPR-1000用マウンティングプレート:2枚

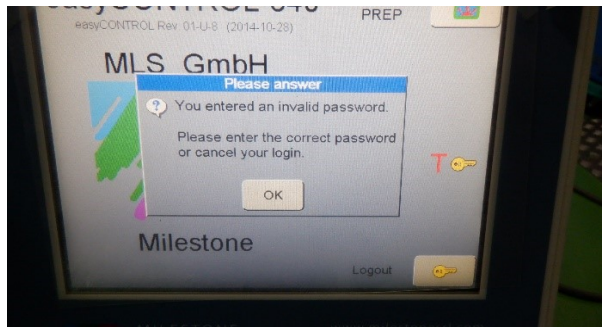

パスワードが不明の為、ログインできない。



内部モニター画面



取扱説明書(無)

修理について

年月日	修理・改造記録	作業者
	パスワード解除(初期設定)費用:約70,000円、使用に当たっては、 点検費用、取扱説明費用が、凡そ20~25万円発生する。	
	修理等連絡先:マイルストーンゼネラル(株) tel044-850-3811 営業 中村様	

(備考欄コメント)

[責任者]




動作(-) 作業工数[4H]

検査担当者[中野]


ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

中野

コントローラ画面

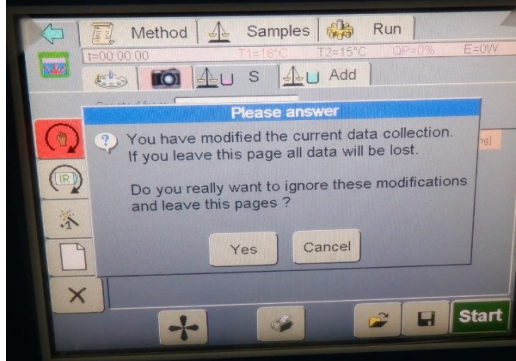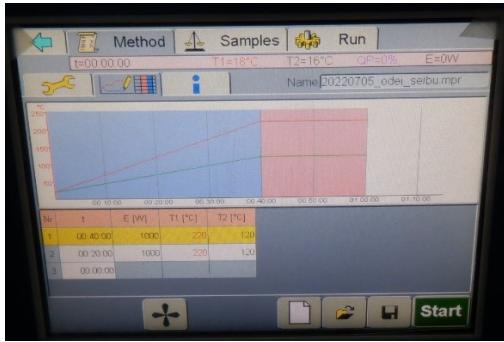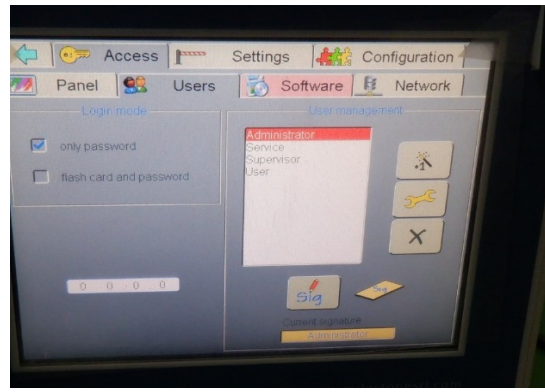

付属品関係





ポロテクションシール30ヶ有り

