管理番号

M90566

動作確認チェックシート

検査日	2022年 12月1日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	3相　200V	排気速度	4200L/min
型式	AA40WNV1-E	周波数	50 ・ 60 Hz	オイル仕様	F油
メーカー名	荏原製作所	吸気フランジ	NW50	重量	240Kg
機械Ser,No	HWA0367D	排気フランジ	NW40		
製造年月	ー	到達圧力	0.2Pa		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	※1○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

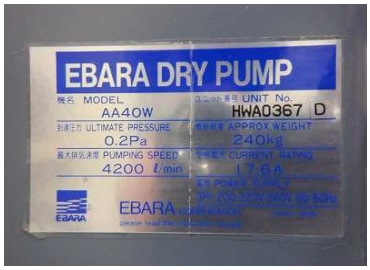

＊排気口部サイレンサーは動作確認用の為付属致しません。

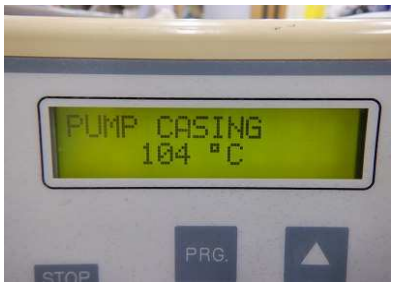

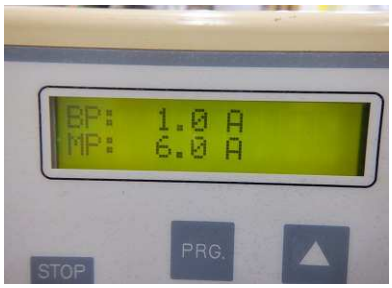

※1・到達圧力：6.0×10^{-1}Pa　　・ポンプ温度：104℃　　・電流値（MP）：6.0A　（BP）：1.0A

＊暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。

取扱説明書（　無　）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作（ OK ）　　作業時間［ 2.5H ］

検査担当者［ 立野 ］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

天野