

管理番号

M90613

## 動作確認チェックシート

検査日	2024年11月18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DC電源	電源電圧	単相	寸法(WxDxH)	490x560x45
型式	PR10-75-01		100V/220V	重量	7.2kg
メーカー名	松定プレジジョン	周波数	50/60Hz	定電圧制御	0~10V
機械Ser.No	034128S	出力電流	0~75A	最大電力	750W
製造年月	-				

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

○外観確認

・問題無し



○動作確認 社内測定器直流電子負荷装置:菊水 PLZ664WAにて確認。

※直流電子負荷装置が650Wまでの仕様の為10V/65Aまでの確認。

・CC動作

65A:0V~10Vにて電流値の変動を確認。

・CV動作

10V:0A~65Aにて電圧値の変動を確認。

5V・65A



10V・65A



10V・10A



10V・65A



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2023/10/24	インターロック解除(TB1) 10-21 ショート (別紙写真あり)	山下

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[1.5H]

検査担当者[山下]


ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日



## インターロック解除

・TB1 10-21 ショート

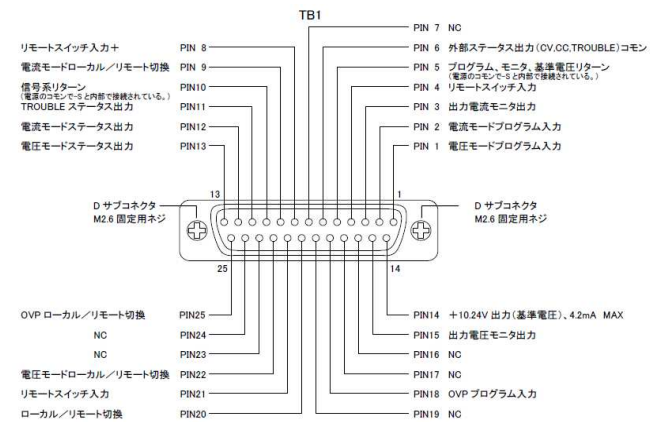

## 単相 100 V 使用時

・ショート

## 単相 200V 使用時

・オープン

