

管理番号

N11536



動作確認チェックシート

検査日	2023年12月26日				
商品名	防振台(除振台)	外観(WxDxH)	400x500x45mm	レベリング方式	自動レベリング (空気供給圧3~7kgf/cm ²)
型式	TA-CR45	外観/フロート部	400x500mm		
メーカー名	特許機器(株)	搭載許容重量	120kg		
機械Ser.No	OS-11321 ₂	製品重量	20kg		
製造年月	2001年10月	エア供給方式	コンプレッサー 工場エア等		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・振動・漏電・モーター逆回転)はないか。	○
3 姿勢制御SW設定	エアースW及び空気バネの機能は正常か。	×
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・吸排気管の防塵処理・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1.外観目視確認⇒問題なし。
- 2.エア供給制御動作確認⇒約0.4MPaのエアを供給及び負荷120kgを載せて制御動作確認⇒リーク有。

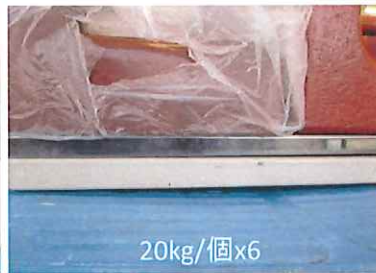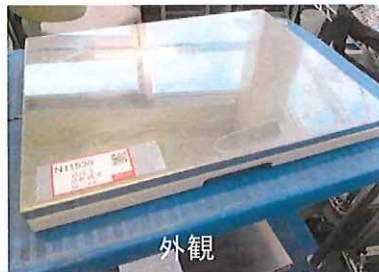

取扱説明書: 無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力
動作:NG 作業工数[2.5 hr]

(備考欄コメント)

[責任者]

検査担当者[雨宮]

