

管理番号

N20562


動作確認チェックシート

検査日	2024年1月18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリーポンプ	電源電圧	三相200V	重量	61Kg
型式	2033CP1	周波数	(50 / 60)Hz	外寸wxdxh(本体)	750x213x375
メーカー名	アルカテル	排気量	450/533L/min	吸気	NW40
機械Ser.No		オイル	約3.3L	排気	NW40
製造年月		到達圧力	0.3Pa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	-
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7 確認シール		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1、弊社真空度計で 3.9×10^{-1} Pa以下を確認。1H連続運転。

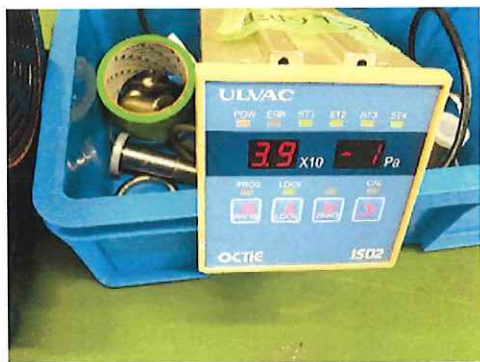

取扱説明書(無)

ポンプを真空計と接続、ミストトラップ別



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2024年1月	オイル交換。	上田

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

