

N40435

動作確認チェックシート

検査日	2025年 6月 24日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	トルクメーター	電源	DC8V 0.5A	重量	約1.8kg
製造年月	(2016年以前)		内部バッテリー式	ピーク時測定範囲	N・m0.015~1.000
メーカー名	ハリオス		ACアダプター付属		N・cm1.5~100.0
本体寸法	W230×D124×H65.2	型名	HP-10	精度	±0.5%以内FS
アルミケース寸法	W345×D90×H280	シリアルNo.	416489	付属品	ハリオスシャンクΦ4


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。又、トルク測定は問題ないか。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC(済・未対象・NG) TP(済・未対象・NG) BT交換(済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認実施。→問題なし。
- 2、通電動作確認実施。→スイッチ・表示・各種設定等、問題なし。
- 3、社内品の電動ドライバーによる比較トルク測定動作確認実施。→問題なし。(社内トルクメーター品は精度一桁まで)

動作確認

トルク測定 トルク目盛	トルクメーター測定値N・m		
	HP-10 N40435	H-100 N60906	
1	0.022	0.02	最小設定
2	0.107	0.10	
3	0.185	0.19	
4	0.261	0.26	
5	0.346	0.34	最大設定
6	0.414	0.41	
7	0.490	0.49	
電動ドライバー J80144			

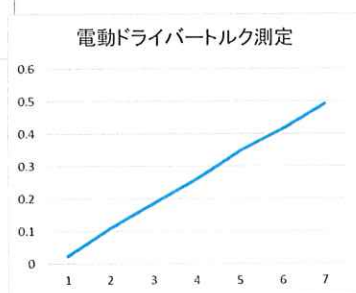

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業員

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4H]

検査担当者[小林(克)]

ユーザー名[

]出荷日 年 月 日

