

動作確認チェックシート

検査日	2025年 6月 3日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	コールドライト	電源電圧※	単相100～120V, 200～240V	ランプ形式	JCR12V100W10 H
型式	MegaLight 100	周波数	50/50Hz		
メーカー名	ショットモリテックス(株)	大きさ(W×D×H)	76×235×120mm		
機械Ser.No	N23Z68440	ライトガイド	2本,1m	※底部に100-120V, 200-240Vの切替スイッチあり	
製造年月	不明	消費電力	約150W		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ライトコントロール正常動作。
- ライトコントロールMAX状態で20分間運転、問題なし。
- 照度計でライトから約30cm離れた位置を測定。

照度	単位:Lx	
ライトコントロール	各1本	2本合わせ
MAX	1310	2680
MIN※	18	18

MINはバックグラウンド値と同じでほぼゼロ状態

照度計: CUSTOM製 LX-1334

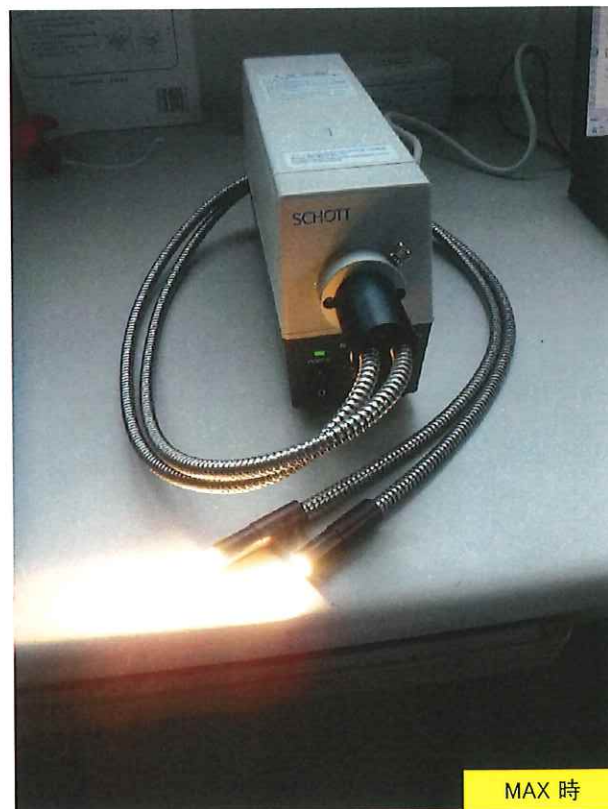

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1H]

検査担当者[野沢]

