

動作確認チェックシート

検査日	2025年 2月 10日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	高電圧差動プローブ	電源電圧	DC 6V~9V		
型式	700924	最大入力電圧	1400V		
メーカー名	YOKOGAWA	周波数帯域	DC~100MHz		
機械Ser,No	73306	減衰比	1/1000, 1/100		
製造年月	年 月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ POWER, RATIO 確認

◎ 表示類 ○ (LED) POWER, OVERRANGE 確認


◎ 動作 Tektronix TDS764C, AFG3100, NF HVA4321 使用




DC1000V入力 1/1000 1V出力




DC100V入力 1/100 1V出力

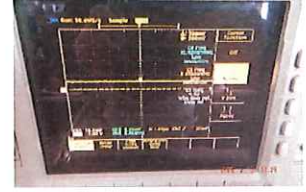

DC1000V 1/1000 1.2MΩ+1.2MΩ分圧入力 0.5V出力



取扱説明書(無) AC1000Vpp,1KHz入力 0.5Vp, 1KHz出力



AC1000Vpp,10KHz入力 0.5Vp, 10KHz出力

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[6H] 専用電源, ACアダプター電源, 電池(単3×4)使用確認済。

検査担当者[佐藤]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

