

管理番号

N70771

# 動作確認チェックシート

検査日	2024年 3月 21日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	デジタルハイトゲージ	使用電池	CR2034	
型式	192-613(HD-30A)			
メーカー名	ミットヨ			
機械Ser.No	9721009			
製造年月	不明			


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


測定方法ハイトマスターにて測定



110mm測定

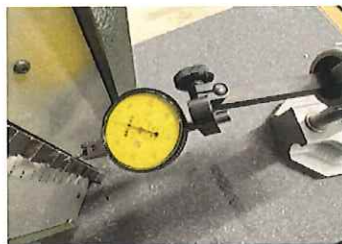

150mm測定

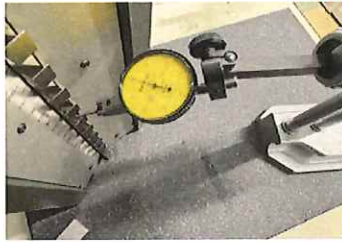

210mm測定



測定結果(mm)	
10	10.00
50	50.02
110	110.03
150	150.04
210	210.04
250	250.04
290	290.02

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 4 H]  
 検査担当者[ 三科 ]

