

N70772

動作確認チェックシート

検査日	2024年11月21日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	コントローラー (レーザー寸法測定器)	電圧	100V 50/60Hz	波長	670nm
型式	LS-5500/LS-5120T	最大出力	0.6mW	レーザー間隔	402mm
メーカー名	KEYENCE	外形寸法	W180xD230xH197 ^{mm}	SCANNING AREA	125mm
機械Ser.No	C4010001/730589		W732xD60xH204 ^{mm}		
製造年月	—	質量	0.45kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1.外観確認実施⇒外観問題なし。
- 2.電源スイッチ投入動作確認実施。⇒問題なし。
- 3.実測及び結果⇒下記図参照。



電源スイッチ投入



レーザー発光確認



高さ"0"LEVEL Adj



高さ"ZERO"調



ゲージブロック20mmを測定



測定値:19.78965mm



ゲージブロック30mmを測定



測定値:29.82825mm

取扱説明書:無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[2.0 hr]

検査担当者[雨宮]



【測定】



ゲージブロック50mmを測定



測定値:49.77470mm



ゲージブロック75mmを測定




測定値:74.79875mm



ラボジャッキ高さ50mm=0 Level

【参考資料】

■ LS-5121

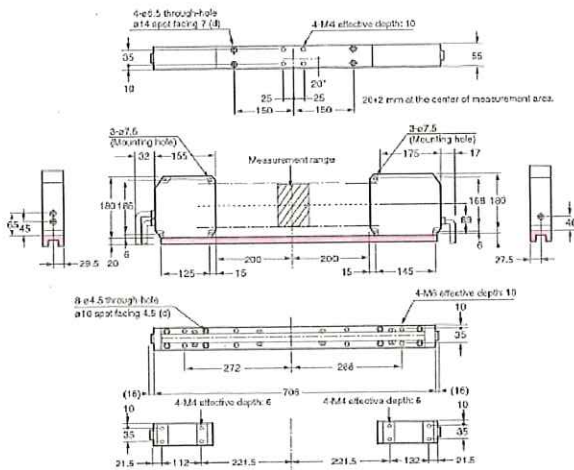

Scanning head front protection cover (Accessory for LS-5121)



■ LS-5501

