


動作確認チェックシート

検査日	2023年 11月 15日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	ターボポンプ	電源	AC100-120v 200-240v 50/60Hz
型式	UMT300/T9B PTI-300	フランジ	VG-100
メーカー	UM アルバック	稼働時間	25.6h

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

オイル注油後電源投入、スタート数分で定格回転到達、圧力 4.4x10⁻⁴Pa確認。
1h連続運転確認、停止動作問題なし。

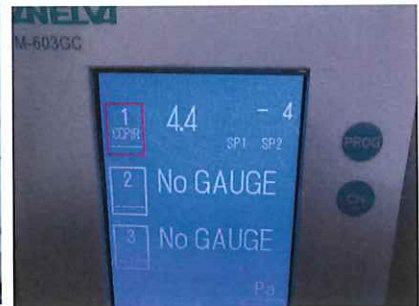

操作説明書(有り)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIHRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4H]
検査担当者[横内]
ユーザー名 []

出荷日 年 月 日

