

動作確認チェックシート

検査日	2023年12月19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	超低温フリーザー	電源電圧	三相200V	温度制御範囲	-130~-152℃
型式	MDF-1156AT-PJ	周波数	(50 / 60)Hz	重量	272Kg
メーカー名	パナソニック	冷媒高温側	HFC500g		
機械Ser,No	140011	冷媒低温側	HFC638g		
製造年月		有効内容積	128L		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 庫内温度11℃、設定温度-152℃、約15時間後-152℃確認。
- 補助冷却装置、ONでソレノイドバルブ常時開、バッテリーNG,テストSW使用不可
- 補助冷却SW,OFFでソレノイドバルブ閉。
- 遠隔警報装置、バッテリーNG,使用不可。
- 自動温度記録計、インクペン、記録紙無し、電池入れて、モーター回転。




付属ケースx5

-152℃確認

バックアップONでソレノイドバルブ開

自動温度記録計インクペン無し。

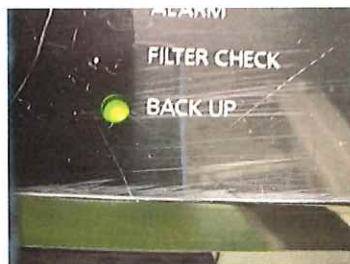

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

