


動作確認チェックシート

検査日	2024年2月22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	真空バルブ(L型)	使用圧力	10 ⁻⁶ Pa~atm		
型式	XLA-100DL-X503	動作圧力	0.4~0.7MPa		
メーカー名	SMC	フランジ	ISO100		
機械Ser,No					
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	—
3 SW設定	SWの機能は正常か。	—
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 真空ポンプに接続オープン、クローズ切替問題無し。
- 2 近接スイッチオープン側NG、D-F9B交換推奨、後継機D-M9B。

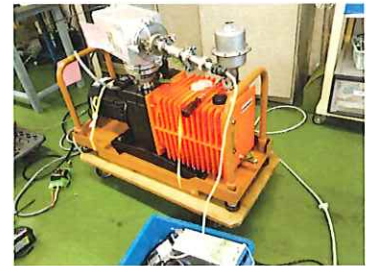


真空ポンプに接続

0.53Pa確認



クローズ点灯。

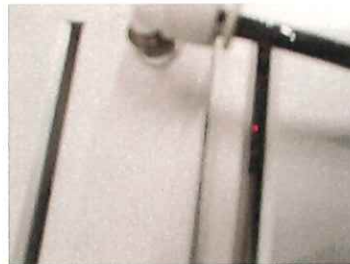

オープン点灯しない。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 出荷日 年 月 日

