

動作確認チェックシート

検査日	2024年9月19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クライオコンプレッサー	電源(50Hz)	3相 190-220V	He圧	1.2MPa
型式	C30	電源(60HZ)	3相 200-230V	積算時間	16707.5Hr
メーカー名	アルバック	消費電力(Kw)	5.0-6.0KW	外寸	W:450 D:530 H:680
機械Ser.No	CC1259	冷却方法	水冷	重量	127Kg
製造年月	-	冷却水量	5.0~1.5L/min		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る	○


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



積算時間:16707.5h



・到達圧力:2.6 × 10⁻⁴Pa

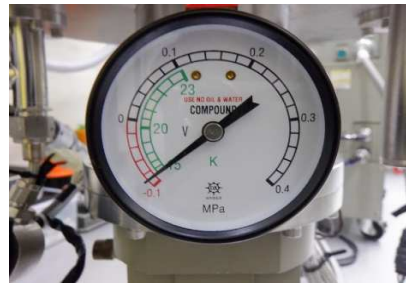

・ 到達温度:15K

取扱説明書(無) *クライオポンプは社内在庫品を使用し動作確認致しました。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業時間[3.5H]		
検査担当者[立野]		
ユーザー名【	】出荷日 年 月 日	

