

動作確認チェックシート

検査日	2025年 6月 24日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	冷熱衝撃試験機	電源	φ3 200V 50/60Hz	予熱上限	200℃
型式	TSA-71H-W	消費電流	112A Max	予冷下限	-77℃
メーカー名	エスベック	冷却水量/圧	25℃(2350L)/0.2~0.5MPa	外寸法	W1310 D1370 H1900
Ser,No	153003164	エア一圧	0.4~0.7MPa	テストエリア寸法	W400 D370 H450
製造年	2007	冷凍機触媒	R404A 5kg , R23 2kg	常温さらし機能	あり

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 温度調節・プログラム機能	仕様範囲の調節が出来るか/プログラム運転での温度制御機能は正常か	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

■外観/槽内部



■200/-75℃温度到達時間(15/50分以内)

高温槽・低温槽の最高/最低温度到達時間を確認する

34℃ → 200℃ 約7分


34℃ → -75℃ 約42分

※測定条件: 槽内はカゴ3個のみ




■動作確認

テストプログラムを作成し、正常に試験が終了するか確認する

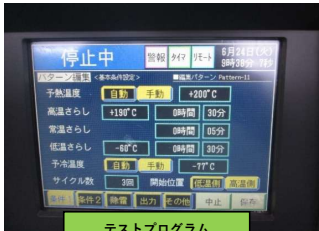

テストプログラム

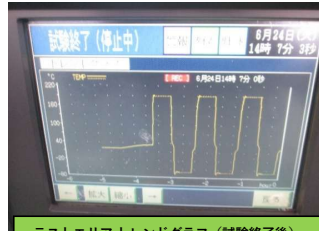

テストエリアトレンドグラフ (試験終了後)

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数[14H] 給水配管の付属品ニップルとストレーナが付いていません(取説59P)

検査担当者[Usunabe]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

