管理番号

O10046

動作確認チェックシート

検査日	2024年3月6日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	クリーンオーブン	電源電圧	三相200V		
型式	DES82H	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	ヤマト科学	清浄度	クラス100		
機械Ser,No	54600006	温度範囲	室温+50～200℃		
製造年月					

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6			
7			

備考(動作確認内容・不具合内容等)　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1　槽内温度16℃、設定温度200℃、約40分で200℃、到達。

2　清浄度、パーティクルカウンター測定、1分5回測定、平均0.3μm、0.5μm共0個であった。

3　過昇防止装置作動、プログラム設定等、問題無し。

200℃

ダンパー閉、窒素流量計OK。

フィルター問題無し

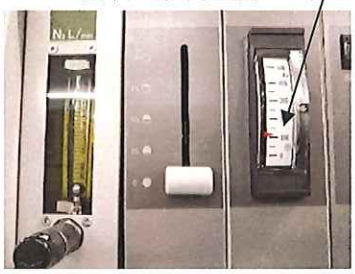

過昇防止装置作動

パーティクルカウンター吸引流量2.83L/min

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録　・再動作	作業者

SHIRASAGI 入力　　(備考欄コメント)　　[責任者]

動作(OK)　　作業工数[2 H]

検査担当者[　　上田　　]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日