

# 動作確認チェックシート

検査日	2024年 8月 8日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	サーモグラフィ	電源	ACアダプター	測定温度	-20~+300℃
年式	2005年		バッテリー-7.4 V1.7Ah	測定距離	30cm~∞
メーカー名	日本アビオニクス	型名	TVS-200	測定波長	8~14μm
寸法	縦220mm×横115mm×高さ105mm	シリアルNo.	1925C0175(AEZ527)	記憶媒体	512MBまで対応
重量	約1.7kg	表示画素数	320(H)×240(V)	表示フレーム数	60フレーム/秒

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	※○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 概観確認実施。→ 問題なし。(但し、記憶媒体が2GBが付属。)
- 通電確認実施。→各機能動作確認問題なし。 ※但し、付属バッテリーの充電完了後の使用時間が短いので劣化している。
- 社内用ホットプレート表面温度を比較測定実施。→問題なし。

## 動作確認

ε:0.81測定

		管理No.M80198 ホットプレート 測定箇所温度 °C					
	測定器	設定温度°C	①	②	③	④	⑤
1	対象品 TVS-200	100	99.5	99.5	102.5	99.5	99.9
		200	196.4	195.5	206.1	199.7	199.5
		250	247.1	247.3	252.3	249.9	249.6
2	社内測定器 HL-200	100	101.4	101.7	104.3	103.2	101.3
		200	198.9	198.3	207.7	206.7	205.2
		250	246.4	247.1	253.4	256.3	256.6

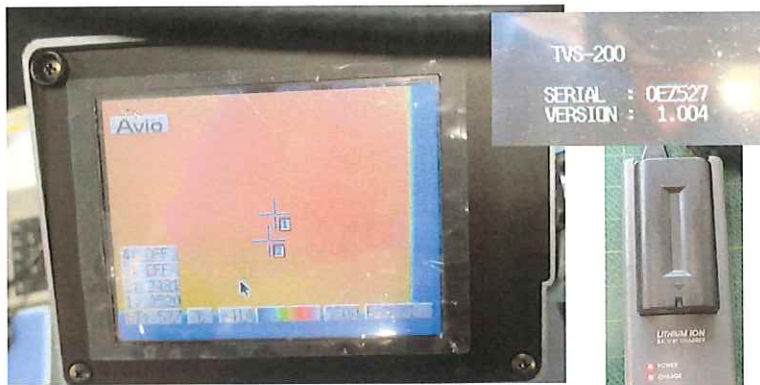

取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力 動作(OK) 作業工数[ 2.5H ] 検査担当者[ 小林(克) ] ユーザー名【	(備考欄コメント)	[責任者]
】出荷日	年 月 日	