

動作確認チェックシート

検査日	2024年3月1日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ブロック恒温槽	電源電圧	AC110V		
型式	Sahara310	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	アズワン(ROCKER)	ヒーター	120W		
機械Ser.No	179310-11-BBZE010	設定温度範囲	室温+5~150℃		
製造年月		ブロック無し			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 槽内温度(ブロック無し)38.2℃、設定温度150℃で起動、約12分で150℃以上確認。
- 槽内に水を入れて、設定温度60℃、到達後、5分間0~0.2℃で推移。
- プログラム設定、OFFタイマー設定問題無し。

150℃以上確認。タイマー問題無し。



槽内に水

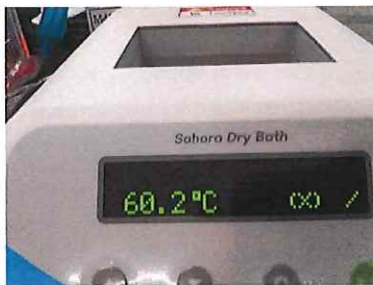

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1,5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

