

(管理番号)

入力	責任者	検査担当者
	中野	坂野


## Heリークディテクター動作確認チェックシート

検査日	2023年 5月 9日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	He リークディテクター	電源電圧	100V	校正リーク	$6.7 \times 10^{-9} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$
型式	MSE-2012S	周波数	50・60Hz		
メーカー名	SHIMADZU	吸気フランジ	NW-25		
機械Ser.No	7347	排気フランジ			
製造年月	2015	FOR PUMP	Neo Dry 15		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 起動時間(AUTO CALが終了するまでの時間)約13分
2. リークレート表示は問題なき動作を確認。AUTO CALも良好
3. TMP、R/P等の排気系も正常に動作している。
4. AUTO TUNING 結果 GOOD

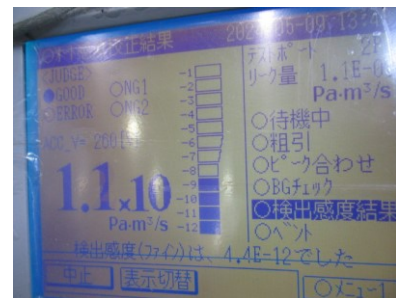

取扱説明書(有)

### 修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

入力 (備考欄コメント)  
動作 OK (1.0 H)