

## 動作確認チェックシート

検査日	2024年9月30日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クライオコンプレッサー	電源	3相 200V	冷却水継手	Rc3/8 メス
型式	CRC-420MK II	周波数	50/60Hz	外寸(mm)	480×520×460
メーカー名	アネルバ	冷却方式	水冷式	積算時間	17405.1Hr.
機械Ser.No	2202002B	冷却水温	30℃以下	質量	75Kg
製造年月	—	冷却水量	180L/h		


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力/温度	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



・コンプレッサーCRC-420MK II (O51206)

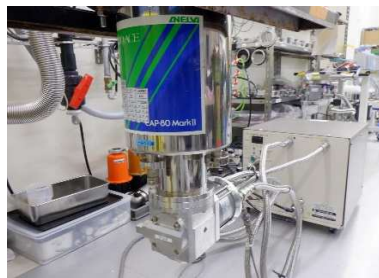

・クライオポンプ(社内在庫品:CAP-80Mark II)

・到達圧力 :  $2.5 \times 10^{-4}$  Pa

取扱説明書(無)

\*クライオポンプ(社内在庫:O51209)CAP-80Mark II 使用し動作確認致しました。

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[3.5H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【

】出荷日

年

月

日

