

管理番号

060282


# 動作確認チェックシート

検査日	2024年 8月 20日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	自動融点測定装置	電源	ACアダプターAC100-240V	測定項目	融点と融解範囲
型式	MP80		50/60Hz		沸点
メーカー名	メトラー・トレド	本体DC24V 5A	曇点		
機械Ser.No	B831192870	装置サイズ	350×180×190mm		上昇融点
製造年月	—————	重量	4000g	付属品	各キャピラリ

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 機能	機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認。 → 問題なし。
- 2、通電動作確認。 → 操作スイッチ機能や表示機能は問題なし。(正常立上げ確認)
- 3、沸点動作確認。 → 蒸留水での沸点動作確認問題なし。  
(蒸留水をキャピラリにセットして、マニュアルメソッドを使用した測定の実行。)

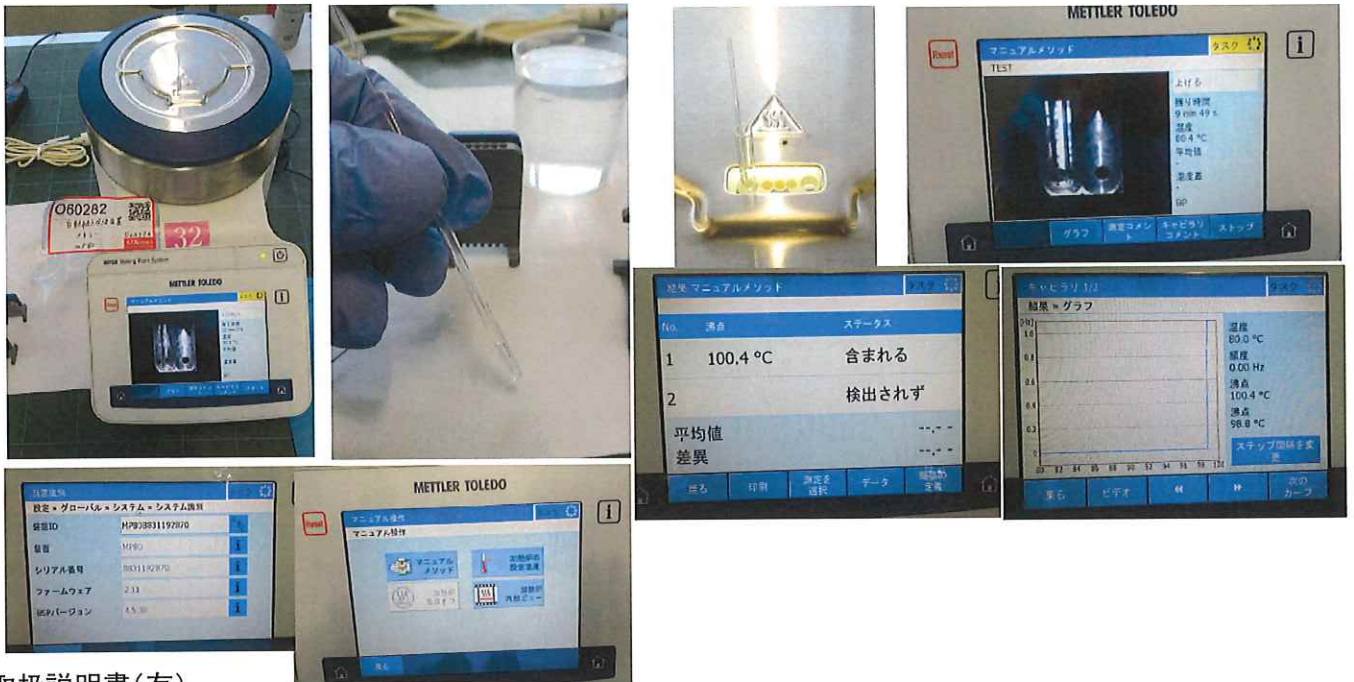

取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

動作(OK) 作業工数[ 7H ]

検査担当者[ 小林(克) ]

ユーザー名【

(備考欄コメント)

】出荷日 年 月 日

[責任者]

