


管理番号

060607

動作確認チェックシート

検査日	2024年9月13日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリーポンプ	電源・電圧	3P 200V	冷却法	空冷
型式	2010 C2	周波数	50・60 Hz	排気速度	162・193L/min
メーカー名	アルカテル	吸気フランジ	NW25	重量	26Kg
機械Ser.No	354932	排気フランジ	NW25		
製造年月	—	規格値(到達圧力)	2×10^{-1} Pa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	×
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	※1○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

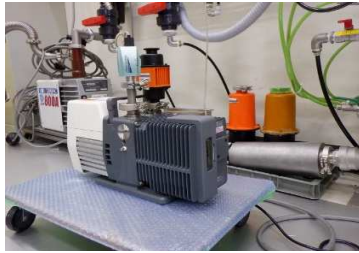

* オイルミストトラップは検査用の為、付属致しません。



※1 到達圧力: 6.3Pa



電流値: 8.89A(異音発生と同時に電流値も上昇しました。)

・起動数分後に電流値が上昇し異音が発生します。

取扱説明書(無)

* 異音発生の為、動作確認は中止しました。 ご使用の際はOHが必要です。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[1.5H]

※異音発生の為、動作確認は中止。

検査担当 [立野]

※ご使用の際はOHが必要です。

ユーザー名【

】出荷日

年 月 日

