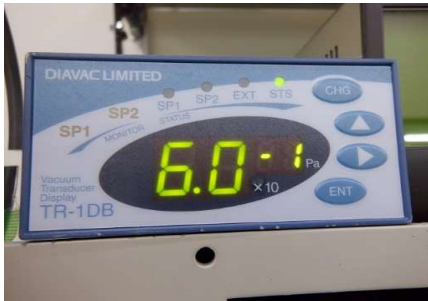


動作確認チェックシート

| 検査日 | 2024年10月30日 | (機械の仕様・規格を記入する。) | | | |
|----------|-------------|------------------|--------------------------------|-------|--------------|
| 商品名 | ロータリーポンプ | 電源・電圧 | 3P 200V | 排気速度 | 240・290L/min |
| 型式 | D-240DK | 周波数 | 50・60 Hz | 使用オイル | R-7 |
| メーカー名 | アルバック | 吸気フランジ | NW25 | 外寸 | 500×231×251 |
| 機械Ser.No | A25A-01417 | 排気フランジ | G1(TMX-1付属) | 重量 | 30kg |
| 製造年月 | — | 規格値(到達圧力) | $6.7 \times 10^{-1} \text{Pa}$ | | |

| チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|-----------|---|----------|
| 1 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。 | ○ |
| 2 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いかな。 | ○ |
| 3 SW設定 | SWの機能は正常か。 | ○ |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。 | ○ |
| 5 到達圧力 | 機器の仕様/規格を満たしているか。 | ○ |
| 6 確認シール | 動作確認済シールを貼る。 | ○ |

到達圧力: $6.0 \times 10^{-1} \text{Pa}$

・電流値: 2.17A

取扱説明書(無)

* 暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。

修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間 [3.0H]

検査担当者 [立野]

ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日

