


管理番号

060634

動作確認チェックシート

検査日	2024年9月12日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリーポンプ	電源・電圧	単相 100V	冷却法	空冷
型式	GLD-137E	周波数	50・60 Hz	定格電流	6.1/5.3 A
メーカー名	アルバック	ホース口吸気管	φ22×□50	排気速度	135/162 L/min
機械Ser.No	1982323	排気ユニット	オイルミストトラップ	重量	30 kg
製造年月	2019	規格値(到達圧力)	0.67 Pa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○
6 到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	○

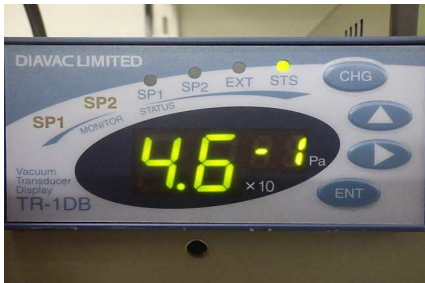

到達圧力 : 0.46Pa

電流値 : 2.66A

※検査時、到達圧力を測定するため吸気フランジ取り替えております。(出荷時:ホース口吸気管φ22×□50)

取扱説明書(無) 暖気運転60分後、再起動時の到達圧力

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業時間[3.0H]		
検査担当者[金子]		
ユーザー名【	】出荷日	年 月 日

