管理番号

O90164

動作確認チェックシート

検査日	2024年10月8日
商品名	チラー(空冷)
型式	CA-1115A
メーカー名	東京理化器械
機械Ser,No	
製造年月	

(機械の仕様・規格を記入する。)

電源電圧	AC100V	最大流量	12/14L/min
周波数	(50 / 60)Hz		
温度範囲	−20〜20℃		
冷凍機出力	650W		
冷媒	R407c(340g)		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6			
7			

備考(動作確認内容・不具合内容等)　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1)ナイブラインZ150%液、タンクに入れて、24℃で設定温度−20℃、約57分で−20℃確認。

2)流量約12L/min以上。

取扱説明書(無)

約12L/min以上

IN、OUT連結

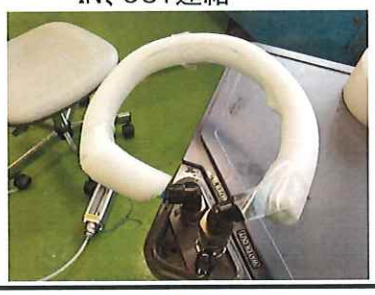

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIRASAGI 入力　　(備考欄コメント)　　[責任者]

動作(OK)　作業工数[3 H]

検査担当者[　　上田　　]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日