

# 動作確認チェックシート


検査日	2024年10月28日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ホットスターラー	電源電圧	AC100V		
型式	CHPS-250DN	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	アズワン				
機械Ser,No	Lot,No,L1508-0023				
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 設定温度500℃、表示500℃で弊社表面温度計で測定、下表示の結果。
- 設定温度550℃で550℃到達。
- 容器に水3L、攪拌子φ8x30mm入れて1500rpm攪拌確認。

表示500℃(弊社表面温度計、測定値の500℃まで)  
センター、及び角より50mm

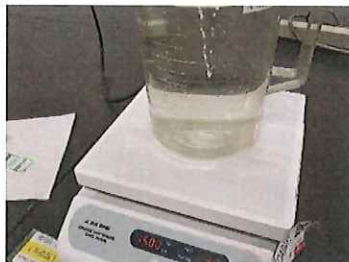

422℃	432℃
477℃	
412℃	428℃

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 3 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

